

中华人民共和国

专项计量授权证书

The People's Republic of China

Certificate of Metrological Authorization for Special Items

(陕) 法 计 (2021) 01 号

陕西卓信工程检测有限公司 :

根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》和《计量授权管理办法》的有关规定，在核定项目范围内，你单位的计量标准经考核评定合格，现授权准予进行计量检定、校准和检测工作，特发此证（授权区域和项目见附件）。

This is to certify that measurement standard of your organization has been examined and deemed to be qualified within the authorized items in accordance with the provisions of the Law on Metrology of the People's Republic of China, the Rules for the Implementation of the Law on Metrology of the People's Republic of China, and the Acts for Metrological Authorization Management. Your organization is hereby authorized to carry out metrological verification, calibration and test (for authorized regions and items shown in the annex).

发证机关：陕西省市场监督管理局
Issued by



批准人签名：
Approved by

刘 蕊 红

发证日期：2021年 1月 11日
Issued on

有效期至：2024年 1月 10日
Valid to

附件 1

授权的检定项目表


陕西卓信工程检测有限公司

第 1 页, 共 1 页

序号	开展检定 项目名称	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	依据检定规程编号
1	精密压力表	(0~60) MPa (测量上限 \geq 0.4MPa)	0.25 级及其以下	JJG 49-2013
2	一般压力表 (不做电接点压力 表)	(0~60) MPa (测量上限 \geq 0.4MPa)	1.0 级及其以下	JJG 52-2013
3	血压计 (表)	(0~40) kPa	± 0.5 kPa	JJG 270-2008

授权区域：本单位。



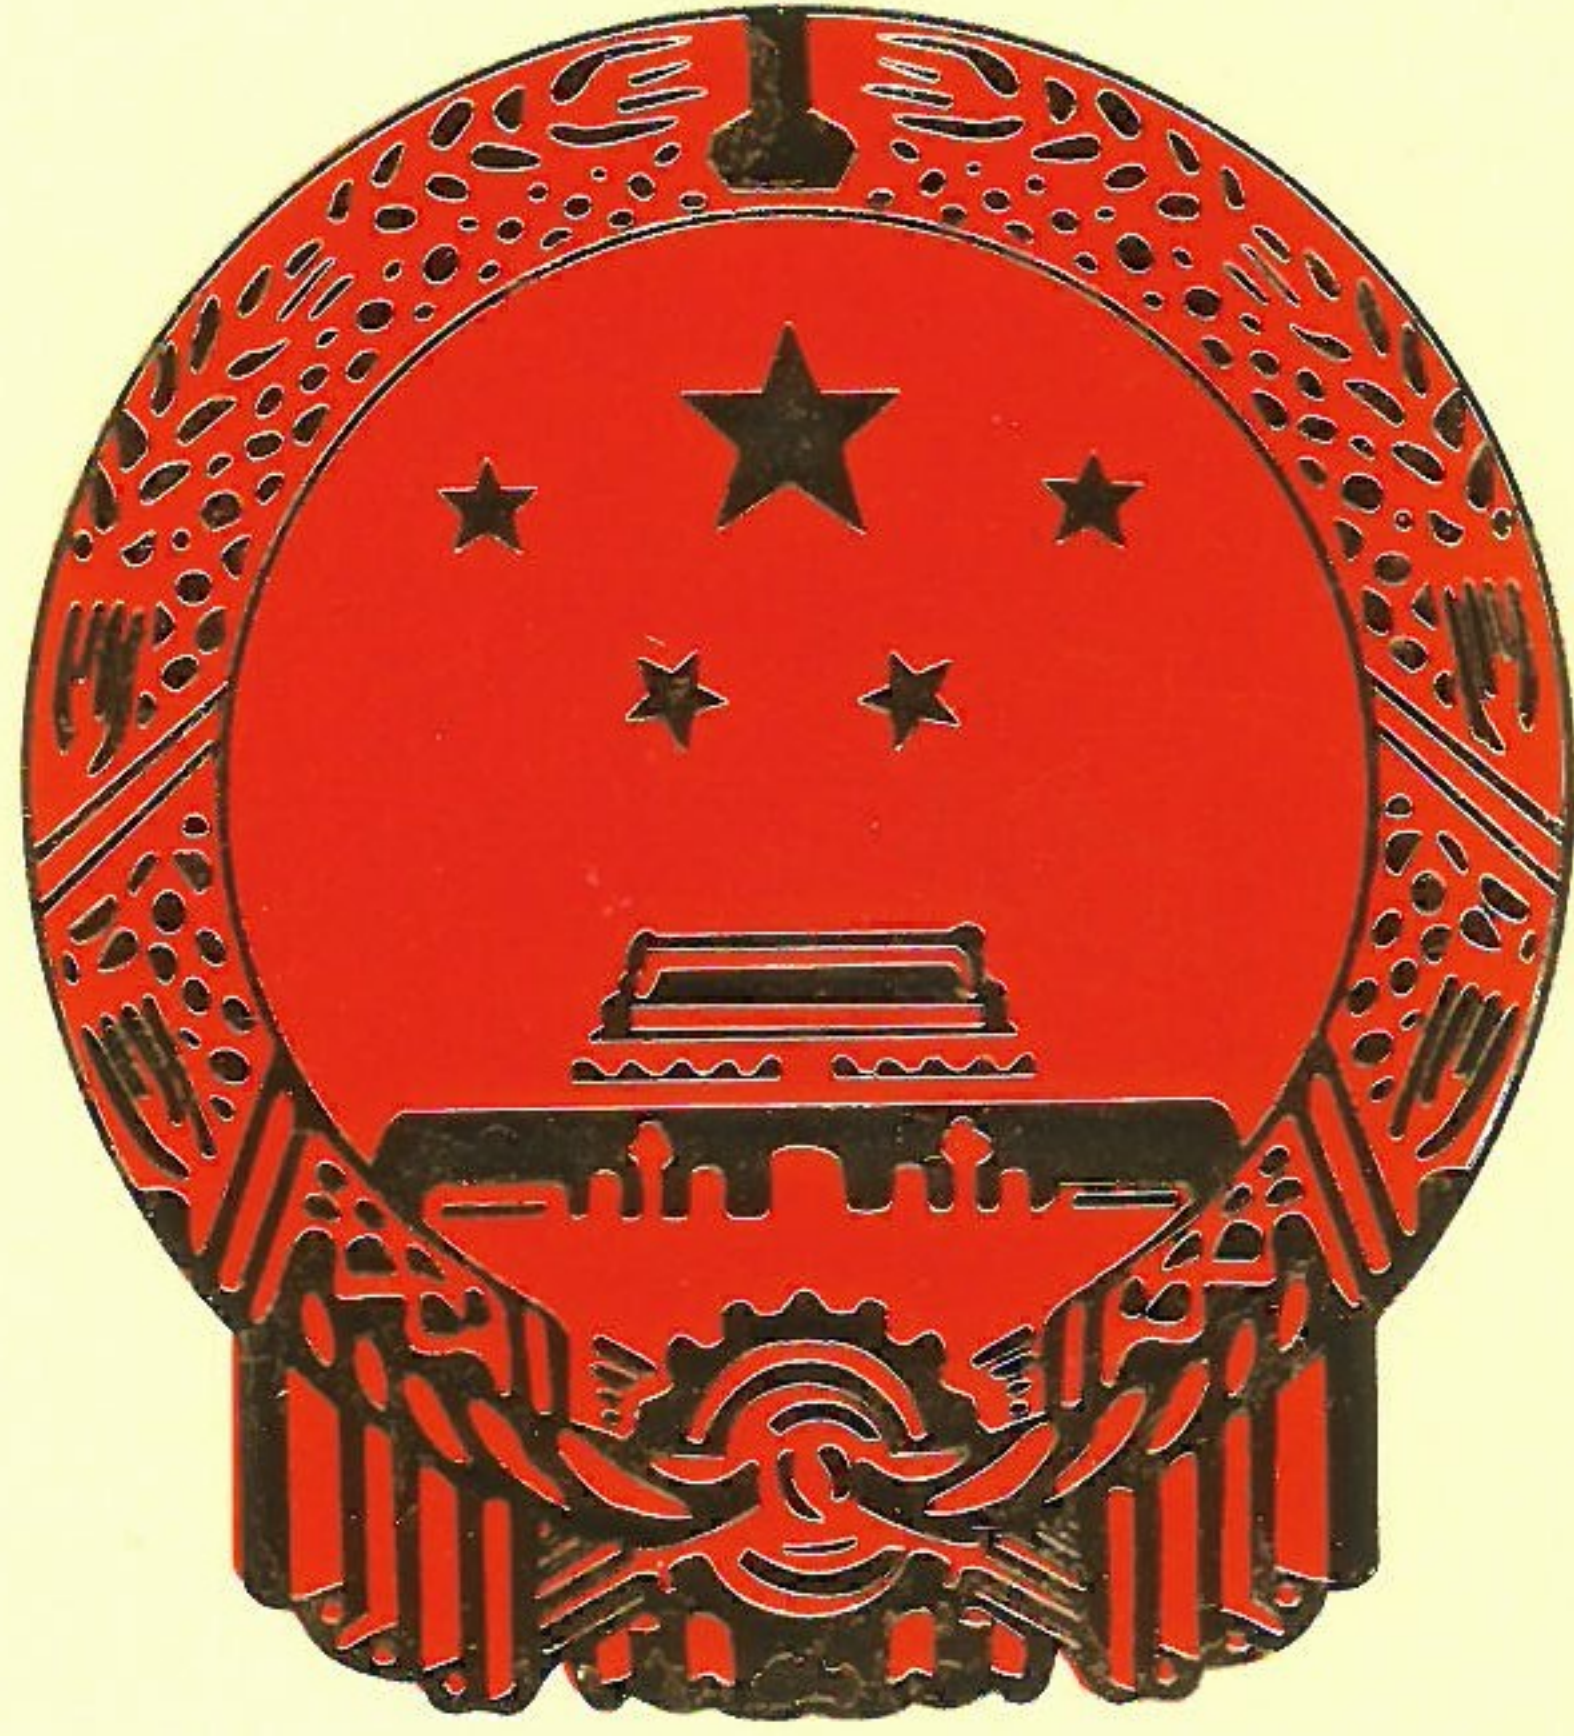

中华人民共和国
专项计量授权证书附件

The People's Republic of China
Annex to Certificate of Special Items of
Metrological Authorization

计量授权证书附件

共 3 页 第 1 页

发证机关提示：

一、被授权单位必须认真贯彻执行计量法律、法规。

二、被授权单位的相应计量标准，必须接受计量基准或者社会公用计量标准的检定。

三、被授权单位开展授权项目工作，必须接受授权单位的监督。

四、被授权单位必须按照授权范围开展工作，需要新增授权项目，应当向授权单位提出新增授权项目申请，经考核合格并获得计量授权后，方可开展新增授权项目的工作。

五、需要继续承担授权任务的被授权单位，在有效期满前六个月应当向授权单位提出申请；授权单位根据需要对被授权单位的申请进行复查，经复查合格的，延长有效期。

六、被授权单位需要终止所承担的授权项目工作，应当提前六个月向授权单位提出书面报告；未经批准不得擅自终止工作。

计量授权证书附件

共 3页 第 2页

机构名称：陕西卓信工程检测有限公司

Name of organization

地址：陕西省西安市雁塔区太白南路189号

Address

法人代表：李秀君

Legal representative

负责人：朱鹏

Person in charge

主管部门：中国中铁一局集团有限公司

Competent authority

授权区域：本企业

Authorized region

授权形式：对内

Authorized type

证书编号：（陕）法计（2021）01号

Number of certificate

发证日期：2021年1月11日

Issued on

有效日期：2024年1月10日

Valid to

发证机关：陕西省市场监督管理局

Issued by



计量授权证书附件

单位：陕西卓信工程检测有限公司

共 3 页 第 3 页

序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to
1	精密压力表	(0~60) MPa (测量上限 \geq 0.4MPa)	0.25 级及其以下	JJG 49-2013
2	一般压力表 (不做电接点压力表)	(0~60) MPa (测量上限 \geq 0.4MPa)	1.0 级及其以下	JJG 52-2013
3	血压计 (表)	(0~40) kPa	± 0.5 kPa	JJG 270-2008
	发证日期 2021 年 1 月 11 日		有效日期 2024 年 1 月 10 日	
	以下空白		以下空白	



计量授权证书附件

共 页 第 页

序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to
	此页空白	此页空白	此页空白	此页空白

